

Thermisch aufbereitbar
nach RKI-Richtlinien

Ermöglicht rücken- und
kräfteschonendes Arbeiten

Bezug einfach zu desinfizieren

HMV-Nr.
22.29.01.2077

MobiTurn®


Umlager- und Wendehilfe
für immobile Patienten

2 JAHRE
GARANTIE *1

Bezug:

- Abnehmbar
- Waschbar bis 95 °C
- Wischdesinfizierbar
- Desinfektionsmittelbeständig*²
- Zur Desinfektion mit Chlor geeignet*²
- Autoklavierbar

Ultraschall verschweißte
Nähte

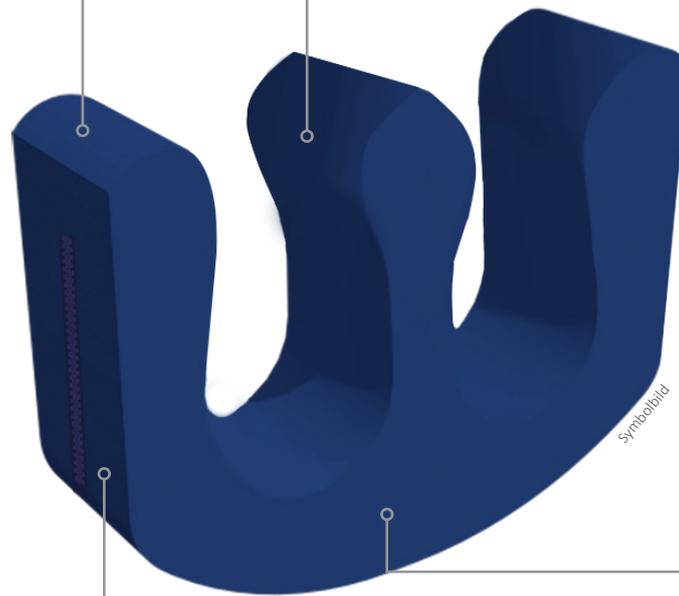

Kern: PU-Schaumstoff

Anwendungsbereiche:


- Ergonomische Form sorgt für eine optimale Patientenumlagerung
- Aufbau ermöglicht eine sichere und schmerzfreie Patientendrehung
- Rückengerechtes und kräfteschonendes Arbeiten für Pflegekräfte und pflegende Angehörige



Bezugsmaterial
viren- und
bakteriendicht
gem. ASTM
1670 + 1671



Wasserdicht
dennoch
atmungsaktiv



Bi-elastischer
Bezug zur
Minimierung
der Scherkräfte



CE- Kennzeichnung
MDR 2017/745



Wartungsfrei



Schwer-
entflammbar
DIN EN 597 (1+2)



Autoklavierbar



Leicht zu
reinigen durch
Wischdesinfektion



Max. 5000 ppm



Rückengerecht
und kräfteschonend



Patientengewicht:
0 bis 250 kg




Einfache
Patientendrehung

*1 Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften (Pro-Rata-Garantie)!

*2 Details siehe Gebrauchsanweisung.



Mit der Umlager-/Wendehilfe MobiTurn® können zu pflegende Personen sicher und schmerzfreier im Bett von der Rückenlage in die Seitenlage gebracht werden. Das Umlagern durch die Pflegekraft wird vereinfacht und somit ein rückengerechtes und kräfteschonendes Arbeiten ermöglicht. Zudem muss bei der Anwendung des Hilfsmittels die individuelle Situation und mögliche Erkrankungen berücksichtigt werden. Bei aufkommenden Fragen, sollte Rücksprache mit dem behandelnden Arzt gehalten werden.

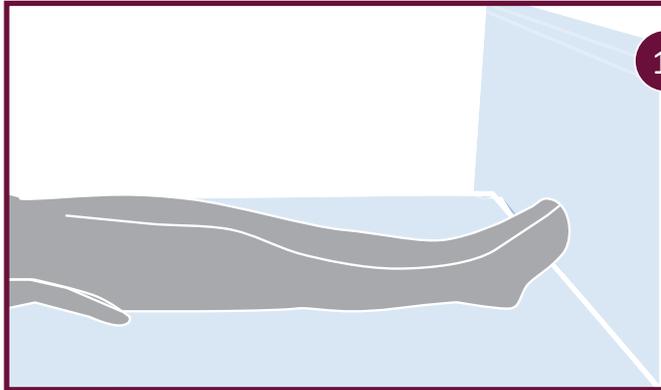

1.

Die zu pflegende Person befindet sich in der Rückenlage flach im Bett. Bitte beachten Sie, dass sich die zu pflegende Person nicht zu nah an der Bettkante befindet, ggf. sollte das vorhandene Bettgitter an der Seite, zu der die zu pflegende Person gedreht werden soll, hochgestellt werden. Dadurch wird das Rausfallen bei der Drehung vermieden.



2.




Die Beine der zu pflegenden Person werden von der Pflegekraft angehoben und das MobiTurn® wird flach unter die Beine gelegt.



3.

Die Beine der zu pflegenden Person müssen gerade in die Aussparungen der Umlager-/Wendehilfe MobiTurn® gelegt werden.

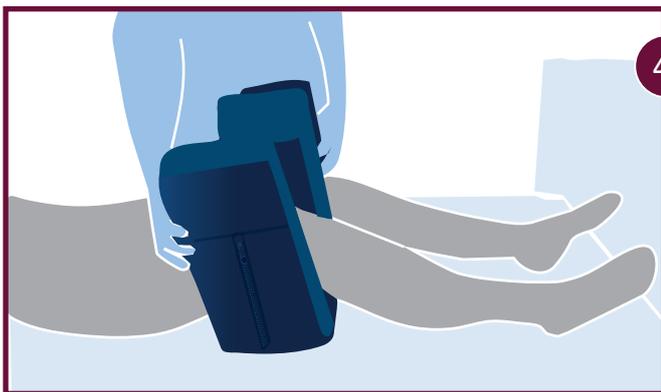

4.

Im nächsten Schritt wird das MobiTurn® aufgestellt. Das MobiTurn® sollte sich im Bereich der Knie der zu pflegenden Person befinden.




5.

Nun wird die zu pflegende Person zum Wenden vorbereitet. Der Arm, welcher von der gewünschten Lagerungsrichtung abgewandt ist, wird auf den Bauch der zu pflegenden Person gelegt. Der andere Arm, welcher sich auf der Lagerungsseite befindet, wird im 90°-Winkel kopfwärts gelagert.



6.


Die Pflegekraft platziert eine Hand am MobiTurn® und eine Hand an der Schulter der zu pflegenden Person, um sie möglichst schonend in die Seitenlagerung zu bringen.

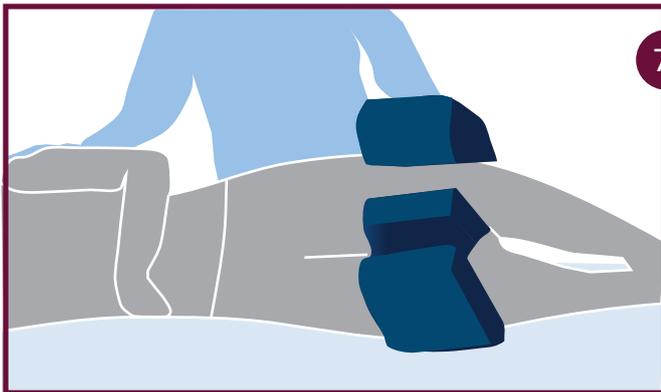

7.

Die zu pflegende Person befindet sich nun in der Seitenlagerung. Nach Stabilisierung der zu pflegenden Person muss die Umlager-/Wendehilfe MobiTurn® entfernt werden.

Falls nur eine kurzzeitige Behandlung in der Seitenlage erfolgen soll, wird die Umlager-/Wendehilfe erst entfernt, wenn die zu pflegende Person nach der Behandlung wieder in die Rückenlage gebracht wurde.

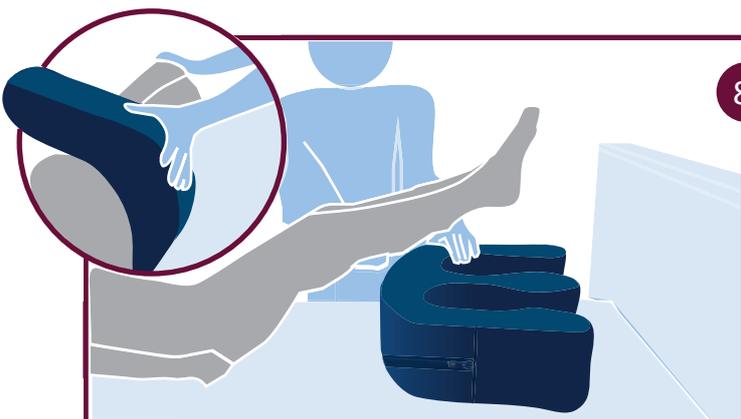

8.

Um die zu pflegende Person wieder in die Rückenlage zu bringen, platziert die Pflegekraft eine Hand am MobiTurn® im Bereich der Kniebeuge und eine Hand an der Schulter der zu pflegenden Person und dreht sie auf den Rücken zurück.

Um das MobiTurn® zu entfernen, wird es in Richtung Bettende gekippt, sodass es flach auf der Matratze liegt. Die Beine der zu pflegenden Person werden angehoben und das MobiTurn® kann entfernt werden.